


MD Prüflabore – Entscheidungsregel

Festlegung von Bewertung der Ergebnisse im Prüflabor:

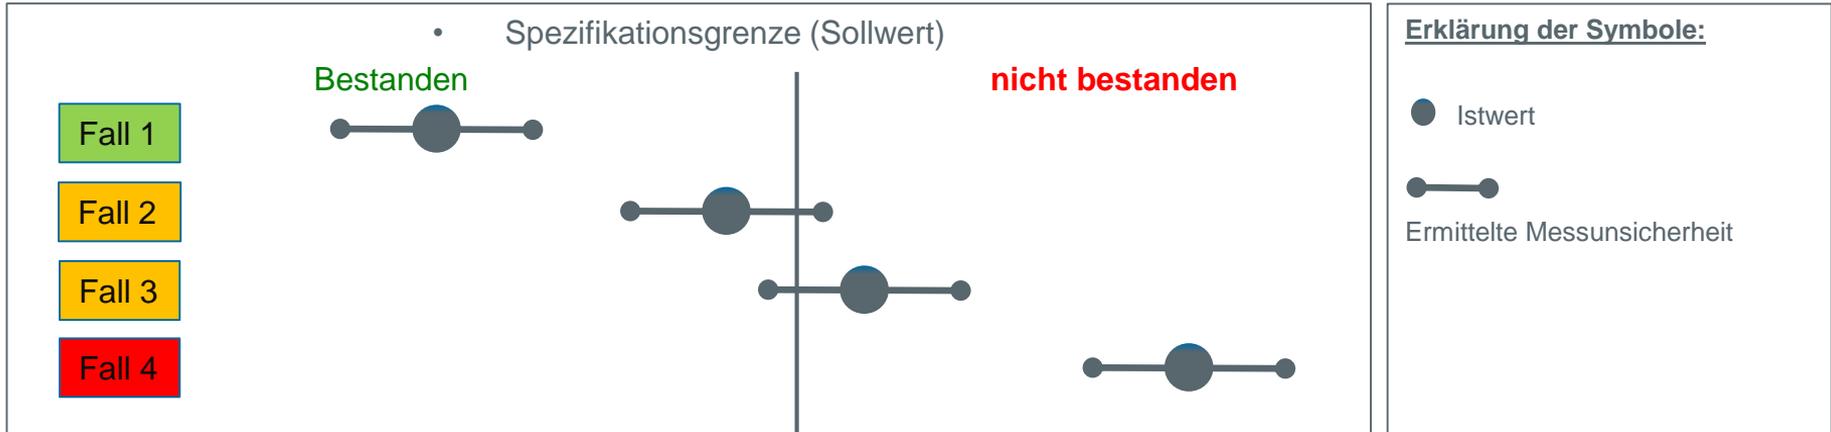

Bezeichnung der Fälle:

Fall 1: Innerhalb der zulässigen Abweichung mit Berücksichtigung der Messunsicherheit

Fall 2: Der Messwert mit seinem Konfidenzintervall überschneidet die Akzeptanzgrenze. Eine klare gut/schlecht-Bewertung

Fall 3: ist auf dem geforderten Signifikanzniveau nicht möglich.

Fall 4: Ausserhalb der zulässigen Abweichung mit Berücksichtigung der Messunsicherheit